

校正証明書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿
型式 RTR501B
名称 Wireless Thermo Recorder
製造者 ティアンドデイ
製造番号 52801B15
管理番号 A-2


東洋テック株式会社
〒101-0021
東京都千代田区外神田1-3-12
TEL 03-3251-8676
FAX 03-3251-8258

試験年月日 2024年 2月 5日
試験環境 温度 : 23℃ 湿度 : 50%
試験場所 浜松キャリブレーションセンター
静岡県浜松市中央区上西町60-3

承認者 佐藤 修平



受領時の機器状態: 校正作業に影響がある外観・機能の異常は見受けられませんでした。
出荷時の機器状態: 測定した項目は仕様を満たしており、調整の実績はありません。

上記の計測器は、当社の品質システムにしたがって校正が行なわれたことを証明します。
この校正に使用した下記の標準器は、日本電気計器検定所及び日本品質保証機構などの
公的校正機関、または米国国立標準技術研究所(NIST)などの国際度量衡委員会に加盟し
ている諸外国の公的校正機関にトレーサビリティがとれています。

使用標準器

管理番号	型式	名称	成績書番号	製造番号	有効期限
0735	TR-1104-001/2114H	シース形白金測温抵抗体/デジタルマルチ温度計	0735-23	H0100/830600074	2024年 8月

注) ・使用標準器の有効期限は表示月の末日です。

試験成績書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

東洋テック株式会社

型式 RTR501B
名称 Wireless Thermo Recorder
製造者 ティアンドデイ
製造番号 52801B15
管理番号 A-2

承認者 佐藤 修平

試験者 佐藤 修平

試験年月日 2024年 2月 5日
試験環境 温度 : 23℃ 湿度 : 50%
試験場所 浜松キャリブレーションセンター
静岡県浜松市中央区上西町60-3

総合判定 良

使用標準器

管理番号	型式	名称	成績書番号	製造番号	有効期限
0735	TR-1104-001/2114H	シース形白金測温抵抗体/デジタルマルチ温度計	0735-23	H0100/830600074	2024年 8月

試験成績

温度指示確度

レンジ	校正値	許容下限値	表示値	許容上限値	判定
-40 ℃	-30.0 ℃	-30.50	-29.7 ℃	-29.50	良
80 ℃	0.0 ℃	-0.50	0.1 ℃	0.50	良
80 ℃	30.0 ℃	29.50	29.9 ℃	30.50	良

備考:

以下余白

校正仕様書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

型 式 RTR501B
名 称 Wireless Thermo Recorder
製 造 者 ティアンドデイ
製造番号 _____
管理番号 _____

試験年月日 ____年__月__日
試験環境 温度 : ____℃ 湿度 : ____%
試験場所 _____



承 認
2024/1/30

試験成績

温度指示確度


レンジ	校正値	表示値		判定基準
-40 ℃	-30.0 ℃	_____℃	±	0.5 ℃
80 ℃	0.0 ℃	_____℃	±	0.5 ℃
80 ℃	30.0 ℃	_____℃	±	0.5 ℃

以下余白

トレーサビリティチャート

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

型 式 RTR501B
名 称 Wireless Thermo Recorder
製造番号 52801B15
管理番号 A-2
試験年月日 2024年 2月 5日

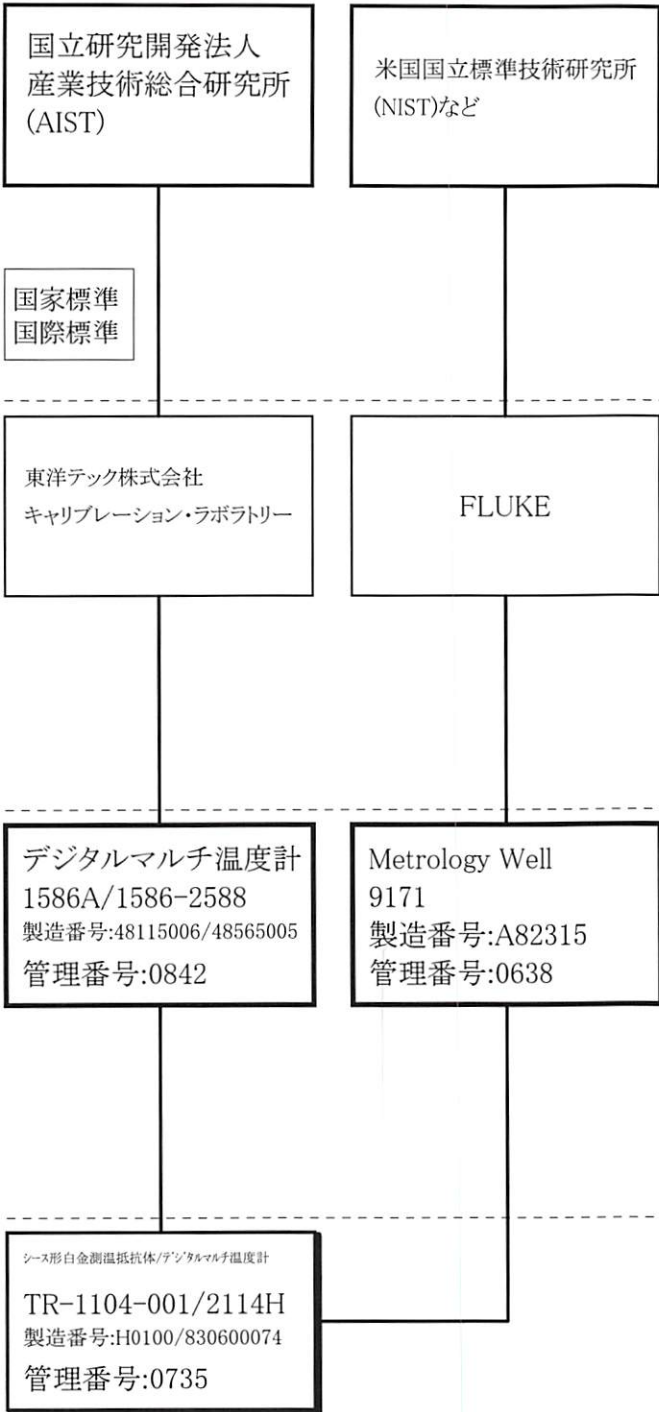

使用標準器

校正証明書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

型式 RTR501B
名称 Wireless Thermo Recorder
製造者 ティアンドデイ
製造番号 52801B1B
管理番号 B-2


東洋テック株式会社
〒101-0021
東京都千代田区外神田1-3-12
TEL 03-3251-8676
FAX 03-3251-8258

試験年月日 2024年 2月 5日
試験環境 温度：23℃ 湿度：50%
試験場所 浜松キャリブレーションセンター
静岡県浜松市中央区上西町60-3

承認者 佐藤 修平



受領時の機器状態： 校正作業に影響がある外観・機能の異常は見受けられませんでした。
出荷時の機器状態： 測定した項目は仕様を満たしており、調整の実績はありません。

上記の計測器は、当社の品質システムにしたがって校正が行なわれたことを証明します。
この校正に使用した下記の標準器は、日本電気計器検定所及び日本品質保証機構などの
公的校正機関、または米国国立標準技術研究所(NIST)などの国際度量衡委員会に加盟し
ている諸外国の公的校正機関にトレーサビリティがとれています。

使用標準器

管理番号	型式	名称	成績書番号	製造番号	有効期限
0735	TR-1104-001/2114H	シース形白金測温抵抗体/デジタルマルチ温度計	0735-23	H0100/830600074	2024年 8月

注)・使用標準器の有効期限は表示月の末日です。

試験成績書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

東洋テック株式会社

型式 RTR501B
名称 Wireless Thermo Recorder
製造者 ティアンドデイ
製造番号 52801B1B
管理番号 B-2

承認者 佐藤 修平
試験者 佐藤 修平

試験年月日 2024年 2月 5日
試験環境 温度 : 23℃ 湿度 : 50%
試験場所 浜松キャリブレーションセンター
静岡県浜松市中央区上西町60-3

総合判定 良

使用標準器

管理番号	型式	名称	成績書番号	製造番号	有効期限
0735	TR-1104-001/2114H	シース形白金測温抵抗体/デジタルマルチ温度計	0735-23	H0100/830600074	2024年 8月

試験成績

温度指示確度

レンジ	校正値	許容下限値	表示値	許容上限値	判定
-40 ℃	-30.0 ℃	-30.50	-29.7 ℃	-29.50	良
80 ℃	0.0 ℃	-0.50	0.2 ℃	0.50	良
80 ℃	30.0 ℃	29.50	29.9 ℃	30.50	良

備考:

以下余白

校正仕様書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

型式 RTR501B
名称 Wireless Thermo Recorder
製造者 ティアンドデイ
製造番号 _____
管理番号 _____

試験年月日 ____年__月__日
試験環境 温度 : ____℃ 湿度 : ____%
試験場所 _____



承認
2024/1/30

試験成績

温度指示確度


レンジ	校正値	表示値		判定基準
-40℃	-30.0℃	_____℃	±	0.5℃
80℃	0.0℃	_____℃	±	0.5℃
80℃	30.0℃	_____℃	±	0.5℃

以下余白

トレーサビリティチャート

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

型 式 RTR501B
名 称 Wireless Thermo Recorder
製造番号 52801B1B
管理番号 B-2
試験年月日 2024年 2月 5日

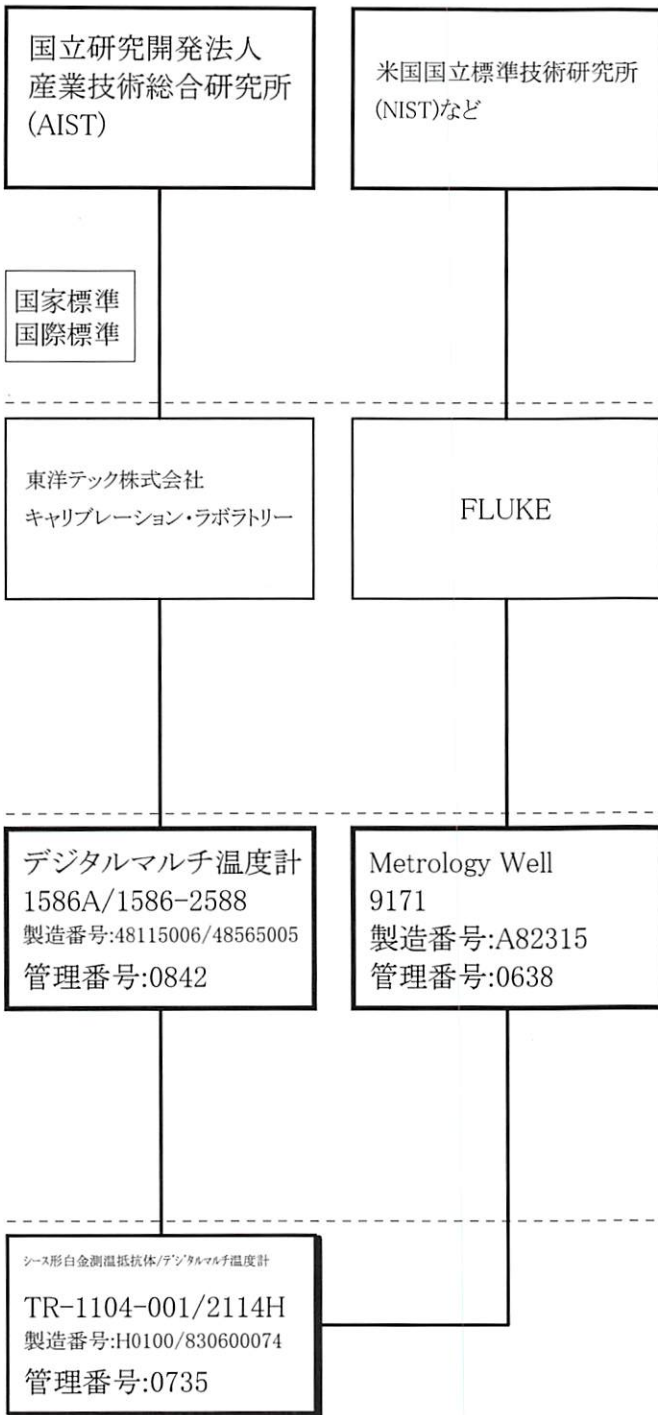

使用標準器

校正証明書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

型 式 RTR501B
名 称 Wireless Thermo Recorder
製 造 者 ティアンドデイ
製造番号 52801974
管理番号 C-2


東洋テック株式会社
〒101-0021
東京都千代田区外神田1-3-12
TEL 03-3251-8676
FAX 03-3251-8258

試験年月日 2024年 2月 5日
試験環境 温度 : 23°C 湿度 : 50%
試験場所 浜松キャリブレーションセンター
静岡県浜松市中央区上西町60-3

承認者 佐藤 修平



受領時の機器状態: 校正作業に影響がある外観・機能の異常は見受けられませんでした。
出荷時の機器状態: 測定した項目は仕様を満たしており、調整の実績はありません。

上記の計測器は、当社の品質システムにしたがって校正が行なわれたことを証明します。
この校正に使用した下記の標準器は、日本電気計器検定所及び日本品質保証機構などの
公的校正機関、または米国国立標準技術研究所(NIST)などの国際度量衡委員会に加盟し
ている諸外国の公的校正機関にトレーサビリティがとれています。

使用標準器

管理番号	型式	名称	成績書番号	製造番号	有効期限
0735	TR-1104-001/2114H	シース形白金測温抵抗体/デジタルマルチ温度計	0735-23	H0100/830600074	2024年 8月

注) ・使用標準器の有効期限は表示月の末日です。

試験成績書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

東洋テック株式会社

型式 RTR501B
名称 Wireless Thermo Recorder
製造者 ティアンドデイ
製造番号 52801974
管理番号 C-2

承認者 佐藤 修平
試験者 佐藤 修平

試験年月日 2024年 2月 5日
試験環境 温度 : 23℃ 湿度 : 50%
試験場所 浜松キャリブレーションセンター
静岡県浜松市中央区上西町60-3

総合判定 良

使用標準器

管理番号	型式	名称	成績書番号	製造番号	有効期限
0735	TR-1104-001/2114H	シース形白金測温抵抗体/デジタルマルチ温度計	0735-23	H0100/830600074	2024年 8月

試験成績

温度指示確度

レンジ	校正値	許容下限値	表示値	許容上限値	判定
-40 ℃	-30.0 ℃	-30.50	-29.8 ℃	-29.50	良
80 ℃	0.0 ℃	-0.50	0.1 ℃	0.50	良
80 ℃	30.0 ℃	29.50	29.8 ℃	30.50	良

備考:

以下余白

校正仕様書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

型 式 RTR501B
名 称 Wireless Thermo Recorder
製 造 者 ティアンドデイ
製造番号 _____
管理番号 _____

試験年月日 ____年__月__日
試験環境 温度 : ____℃ 湿度 : ____%
試験場所 _____



承認
2024/1/30

試験成績

温度指示確度


レンジ	校正値	表示値		判定基準
-40℃	-30.0℃	_____℃	±	0.5℃
80℃	0.0℃	_____℃	±	0.5℃
80℃	30.0℃	_____℃	±	0.5℃

以下余白

トレーサビリティチャート

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

型 式 RTR501B
名 称 Wireless Thermo Recorder
製造番号 52801974
管理番号 C-2
試験年月日 2024年 2月 5日

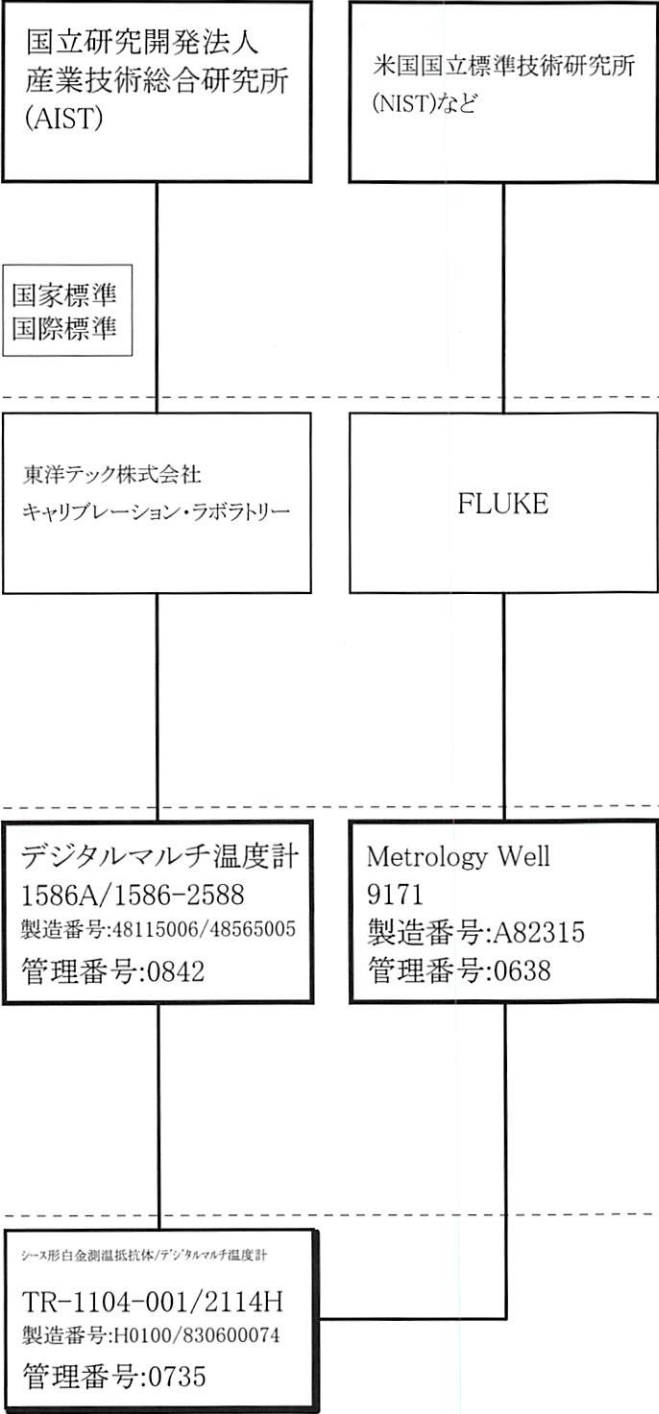

校正証明書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

型 式 RTR501B
名 称 Wireless Thermo Recorder
製 造 者 ティアンドデイ
製造番号 52801DA6
管理番号 D-2


東洋テック株式会社
〒101-0021
東京都千代田区外神田1-3-12
TEL 03-3251-8676
FAX 03-3251-8258

試験年月日 2024年 2月 5日
試験環境 温度 : 23°C 湿度 : 50%
試験場所 浜松キャリブレーションセンター
静岡県浜松市中央区上西町60-3

承認者 佐藤 修平



受領時の機器状態: 校正作業に影響がある外観・機能の異常は見受けられませんでした。
出荷時の機器状態: 測定した項目は仕様を満たしており、調整の実績はありません。

上記の計測器は、当社の品質システムにしたがって校正が行なわれたことを証明します。
この校正に使用した下記の標準器は、日本電気計器検定所及び日本品質保証機構などの
公的校正機関、または米国国立標準技術研究所(NIST)などの国際度量衡委員会に加盟し
ている諸外国の公的校正機関にトレーサビリティがとれています。

使用標準器

管理番号	型式	名称	成績書番号	製造番号	有効期限
0735	TR-1104-001/2114H	シーヌ形白金測温抵抗体/デジタルマルチ温度計	0735-23	H0100/830600074	2024年 8月

注) ・使用標準器の有効期限は表示月の末日です。

試験成績書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

東洋テック株式会社

型式 RTR501B
名称 Wireless Thermo Recorder
製造者 ティアンドデイ
製造番号 52801DA6
管理番号 D-2

承認者 佐藤 修平
試験者 佐藤 修平

試験年月日 2024年 2月 5日
試験環境 温度 : 23℃ 湿度 : 50%
試験場所 浜松キャリブレーションセンター
静岡県浜松市中央区上西町60-3

総合判定 良

使用標準器

管理番号	型式	名称	成績書番号	製造番号	有効期限
0735	TR-1104-001/2114H	シース形白金測温抵抗体/デジタルマルチ温度計	0735-23	H0100/830600074	2024年 8月

試験成績

温度指示確度

レンジ	校正值	許容下限値	表示値	許容上限値	判定
-40 ℃	-30.0 ℃	-30.50	-29.8 ℃	-29.50	良
80 ℃	0.0 ℃	-0.50	-0.1 ℃	0.50	良
80 ℃	30.0 ℃	29.50	29.7 ℃	30.50	良

備考:

以下余白

校正仕様書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

型 式 RTR501B
名 称 Wireless Thermo Recorder
製 造 者 ティアンドデイ
製造番号 _____
管理番号 _____

試験年月日 ____年__月__日
試験環境 温度 : ____℃ 湿度 : ____%
試験場所 _____



承 認
2024/1/30

試験成績

温度指示確度


レンジ	校正値	表示値		判定基準
-40 ℃	-30.0 ℃	_____℃	±	0.5 ℃
80 ℃	0.0 ℃	_____℃	±	0.5 ℃
80 ℃	30.0 ℃	_____℃	±	0.5 ℃

以下余白

トレーサビリティチャート

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

型 式 RTR501B
名 称 Wireless Thermo Recorder
製造番号 52801DA6
管理番号 D-2
試験年月日 2024年 2月 5日

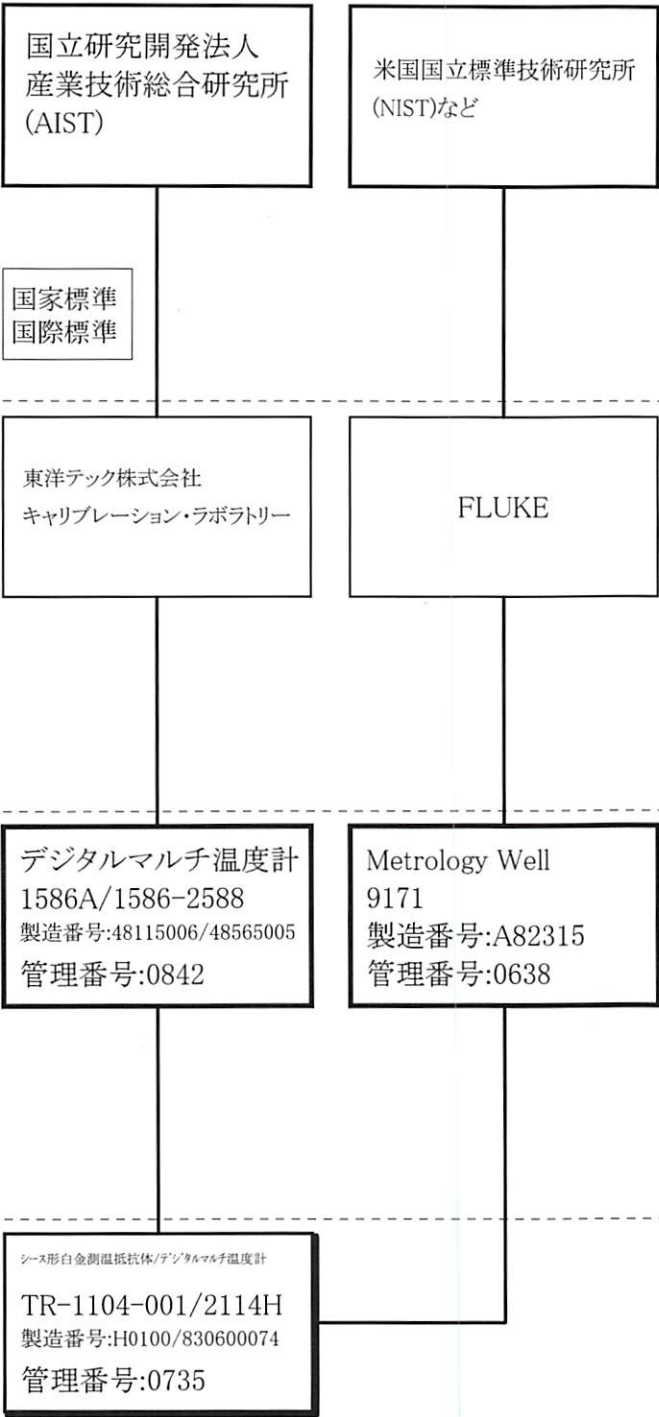

使用標準器

校正証明書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

型 式 RTR501B
名 称 Wireless Thermo Recorder
製 造 者 ティアンドデイ
製造番号 52801B13
管理番号 E-2


東洋テック株式会社
〒101-0021
東京都千代田区外神田1-3-12
TEL 03-3251-8676
FAX 03-3251-8258

試験年月日 2024年 2月 5日
試験環境 温度：23℃ 湿度：50%
試験場所 浜松キャリブレーションセンター
静岡県浜松市中央区上西町60-3

承認者 佐藤 修平



受領時の機器状態： 校正作業に影響がある外観・機能の異常は見受けられませんでした。
出荷時の機器状態： 測定した項目は仕様を満たしており、調整の実績はありません。

上記の計測器は、当社の品質システムにしたがって校正が行なわれたことを証明します。
この校正に使用した下記の標準器は、日本電気計器検定所及び日本品質保証機構などの
公的校正機関、または米国国立標準技術研究所(NIST)などの国際度量衡委員会に加盟し
ている諸外国の公的校正機関にトレーサビリティがとれています。

使用標準器

管理番号	型式	名称	成績書番号	製造番号	有効期限
0735	TR-1104-001/2114H	シース形白金測温抵抗体/デジタルマルチ温度計	0735-23	H0100/830600074	2024年 8月

注)・使用標準器の有効期限は表示月の末日です。

試験成績書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

東洋テック株式会社

型式 RTR501B
名称 Wireless Thermo Recorder
製造者 ティアンドデイ
製造番号 52801B13
管理番号 E-2

承認者 佐藤 修平
試験者 佐藤 修平

試験年月日 2024年 2月 5日
試験環境 温度 : 23℃ 湿度 : 50%
試験場所 浜松キャリブレーションセンター
静岡県浜松市中央区上西町60-3

総合判定 良

使用標準器

管理番号	型式	名称	成績書番号	製造番号	有効期限
0735	TR-1104-001/2114H	シース形白金測温抵抗体/デジタルマルチ温度計	0735-23	H0100/830600074	2024年 8月

試験成績

温度指示確度

レンジ	校正値	許容下限値	表示値	許容上限値	判定
-40 ℃	-30.0 ℃	-30.50	-29.6 ℃	-29.50	良
80 ℃	0.0 ℃	-0.50	0.2 ℃	0.50	良
80 ℃	30.0 ℃	29.50	30.0 ℃	30.50	良

備考:

以下余白

校正仕様書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

型 式 RTR501B
名 称 Wireless Thermo Recorder
製 造 者 ティアンドデイ
製造番号 _____
管理番号 _____

試験年月日 ____年__月__日
試験環境 温度 : ____℃ 湿度 : ____%
試験場所 _____



承 認
2024/1/30

試験成績

温度指示確度

レンジ	校正値	表示値		判定基準
-40℃	-30.0℃	_____℃	±	0.5℃
80℃	0.0℃	_____℃	±	0.5℃
80℃	30.0℃	_____℃	±	0.5℃


以下余白

トレーサビリティチャート

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

東洋テック株式会社

型式 RTR501B
名称 Wireless Thermo Recorder
製造番号 52801B13
管理番号 E-2
試験年月日 2024年 2月 5日

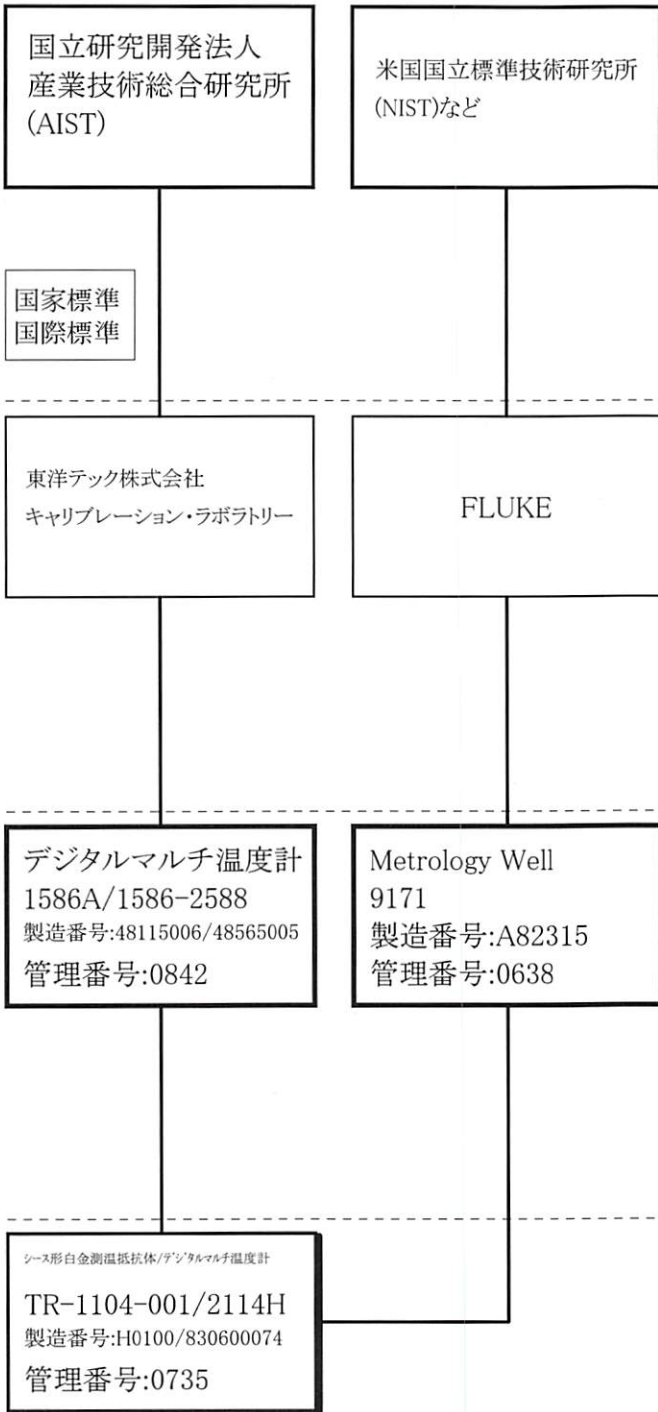

校正証明書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

型 式 RTR501B
名 称 Wireless Thermo Recorder
製 造 者 ティアンドデイ
製造番号 52801986
管理番号 F-2


東洋テック株式会社
〒101-0021
東京都千代田区外神田1-3-12
TEL 03-3251-8676
FAX 03-3251-8258

試験年月日 2024年 2月 5日
試験環境 温度：23℃ 湿度：50%
試験場所 浜松キャリブレーションセンター
静岡県浜松市中央区上西町60-3

承認者 佐藤 修平



受領時の機器状態： 校正作業に影響がある外観・機能の異常は見受けられませんでした。
出荷時の機器状態： 測定した項目は仕様を満たしており、調整の実績はありません。

上記の計測器は、当社の品質システムにしたがって校正が行なわれたことを証明します。
この校正に使用した下記の標準器は、日本電気計器検定所及び日本品質保証機構などの
公的校正機関、または米国国立標準技術研究所(NIST)などの国際度量衡委員会に加盟し
ている諸外国の公的校正機関にトレーサビリティがとれています。

使用標準器

管理番号	型式	名称	成績書番号	製造番号	有効期限
0735	TR-1104-001/2114H	シース形白金測温抵抗体/デジタルマルチ温度計	0735-23	H0100/830600074	2024年 8月

注)・使用標準器の有効期限は表示月の末日です。

試験成績書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

東洋テック株式会社

型式 RTR501B
名称 Wireless Thermo Recorder
製造者 ティアンドデイ
製造番号 52801986
管理番号 F-2

承認者 佐藤 修平
試験者 佐藤 修平

試験年月日 2024年 2月 5日
試験環境 温度 : 23℃ 湿度 : 50%
試験場所 浜松キャリブレーションセンター
静岡県浜松市中央区上西町60-3

総合判定 良

使用標準器

管理番号	型式	名称	成績書番号	製造番号	有効期限
0735	TR-1104-001/2114H	シース形白金測温抵抗体/デジタルマルチ温度計	0735-23	H0100/830600074	2024年 8月

試験成績

温度指示確度

レンジ	校正値	許容下限値	表示値	許容上限値	判定
-40 ℃	-30.0 ℃	-30.50	-29.6 ℃	-29.50	良
80 ℃	0.0 ℃	-0.50	0.3 ℃	0.50	良
80 ℃	30.0 ℃	29.50	30.0 ℃	30.50	良

備考:

以下余白

校正仕様書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

型 式 RTR501B
名 称 Wireless Thermo Recorder
製 造 者 ティアンドデイ
製造番号 _____
管理番号 _____

試験年月日 ____年__月__日
試験環境 温度 : ____℃ 湿度 : ____%
試験場所 _____

東洋テック株式会社

承認
2024/1/30


試験成績

温度指示確度


レンジ	校正値	表示値		判定基準
-40 ℃	-30.0 ℃	_____℃	±	0.5 ℃
80 ℃	0.0 ℃	_____℃	±	0.5 ℃
80 ℃	30.0 ℃	_____℃	±	0.5 ℃

以下余白

トレーサビリティチャート

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

型 式 RTR501B
名 称 Wireless Thermo Recorder
製造番号 52801986
管理番号 F-2
試験年月日 2024年 2月 5日

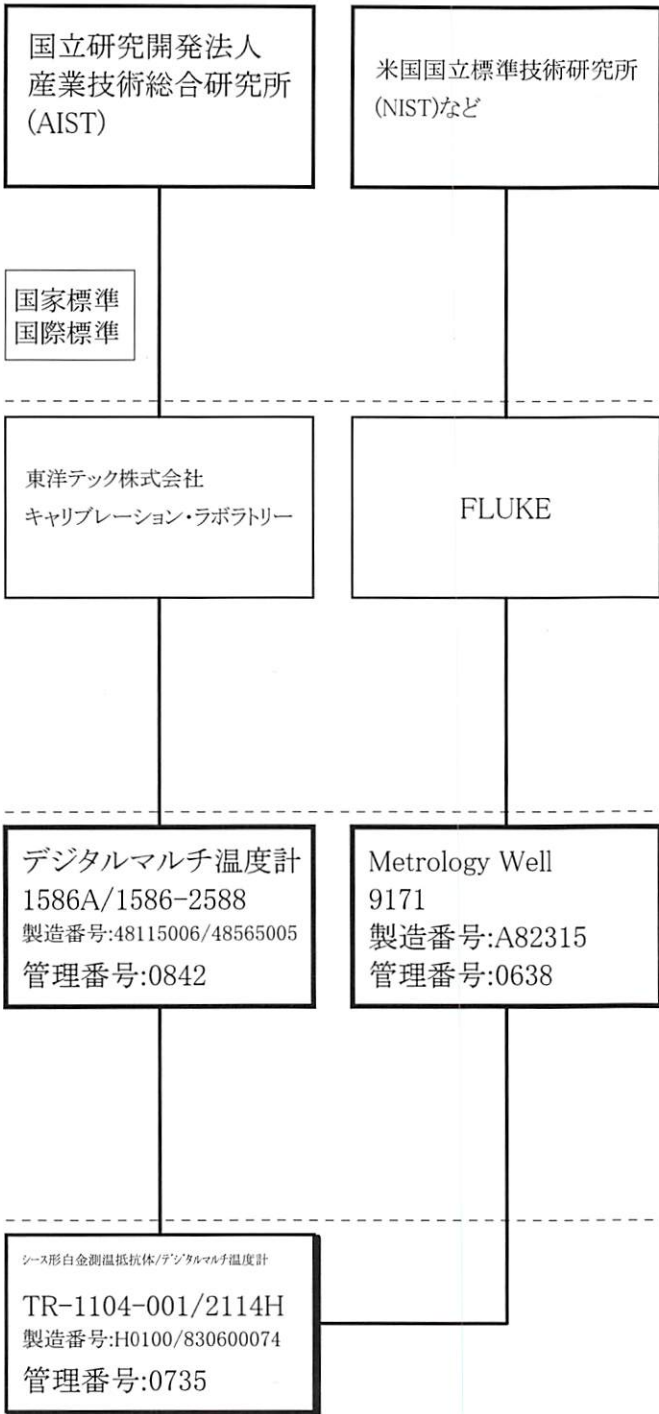

国家標準
国際標準

東洋テック株式会社
キャリブレーション・ラボラトリー

FLUKE

デジタルマルチ温度計
1586A/1586-2588
製造番号:48115006/48565005
管理番号:0842

Metrology Well
9171
製造番号:A82315
管理番号:0638

シース形白金測温抵抗体/デジタルマルチ温度計
TR-1104-001/2114H
製造番号:H0100/830600074
管理番号:0735

使用標準器

校正証明書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿
型式 RTR501B
名称 Wireless Thermo Recorder
製造者 ティアンドデイ
製造番号 52801979
管理番号 G-2


東洋テック株式会社
〒101-0021
東京都千代田区外神田1-3-12
TEL 03-3251-8676
FAX 03-3251-8258

試験年月日 2024年 2月 5日
試験環境 温度 : 23℃ 湿度 : 50%
試験場所 浜松キャリブレーションセンター
静岡県浜松市中央区上西町60-3

承認者 佐藤 修平



受領時の機器状態: 校正作業に影響がある外観・機能の異常は見受けられませんでした。
出荷時の機器状態: 測定した項目は仕様を満たしており、調整の実績はありません。

上記の計測器は、当社の品質システムにしたがって校正が行なわれたことを証明します。
この校正に使用した下記の標準器は、日本電気計器検定所及び日本品質保証機構などの
公的校正機関、または米国国立標準技術研究所(NIST)などの国際度量衡委員会に加盟し
ている諸外国の公的校正機関にトレーサビリティがとれています。

使用標準器

管理番号	型式	名称	成績書番号	製造番号	有効期限
0735	TR-1104-001/2114H	シース形白金測温抵抗体/デジタルマルチ温度計	0735-23	H0100/830600074	2024年 8月

注) ・使用標準器の有効期限は表示月の末日です。

試験成績書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

東洋テック株式会社

型式 RTR501B
名称 Wireless Thermo Recorder
製造者 ティアンドデイ
製造番号 52801979
管理番号 G-2

承認者 佐藤 修平
試験者 佐藤 修平

試験年月日 2024年 2月 5日
試験環境 温度 : 23℃ 湿度 : 50%
試験場所 浜松キャリブレーションセンター
静岡県浜松市中央区上西町60-3

総合判定 良

使用標準器

管理番号	型式	名称	成績書番号	製造番号	有効期限
0735	TR-1104-001/2114H	シース形白金測温抵抗体/デジタルマルチ温度計	0735-23	H0100/830600074	2024年 8月

試験成績

温度指示確度

レンジ	校正値	許容下限値	表示値	許容上限値	判定
-40 ℃	-30.0 ℃	-30.50	-29.6 ℃	-29.50	良
80 ℃	0.0 ℃	-0.50	0.2 ℃	0.50	良
80 ℃	30.0 ℃	29.50	29.9 ℃	30.50	良

備考:

以下余白

校正仕様書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

型 式 RTR501B
名 称 Wireless Thermo Recorder
製 造 者 ティアンドデイ
製造番号 _____
管理番号 _____

試験年月日 ____年__月__日
試験環境 温度 : ____℃ 湿度 : ____%
試験場所 _____



承認
2024/1/30

試験成績

温度指示確度

レンジ	校正値	表示値		判定基準
-40 ℃	-30.0 ℃	_____℃	±	0.5 ℃
80 ℃	0.0 ℃	_____℃	±	0.5 ℃
80 ℃	30.0 ℃	_____℃	±	0.5 ℃


以下余白

トレーサビリティチャート

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿



型 式 RTR501B
名 称 Wireless Thermo Recorder
製造番号 52801979
管理番号 G-2
試験年月日 2024年 2月 5日

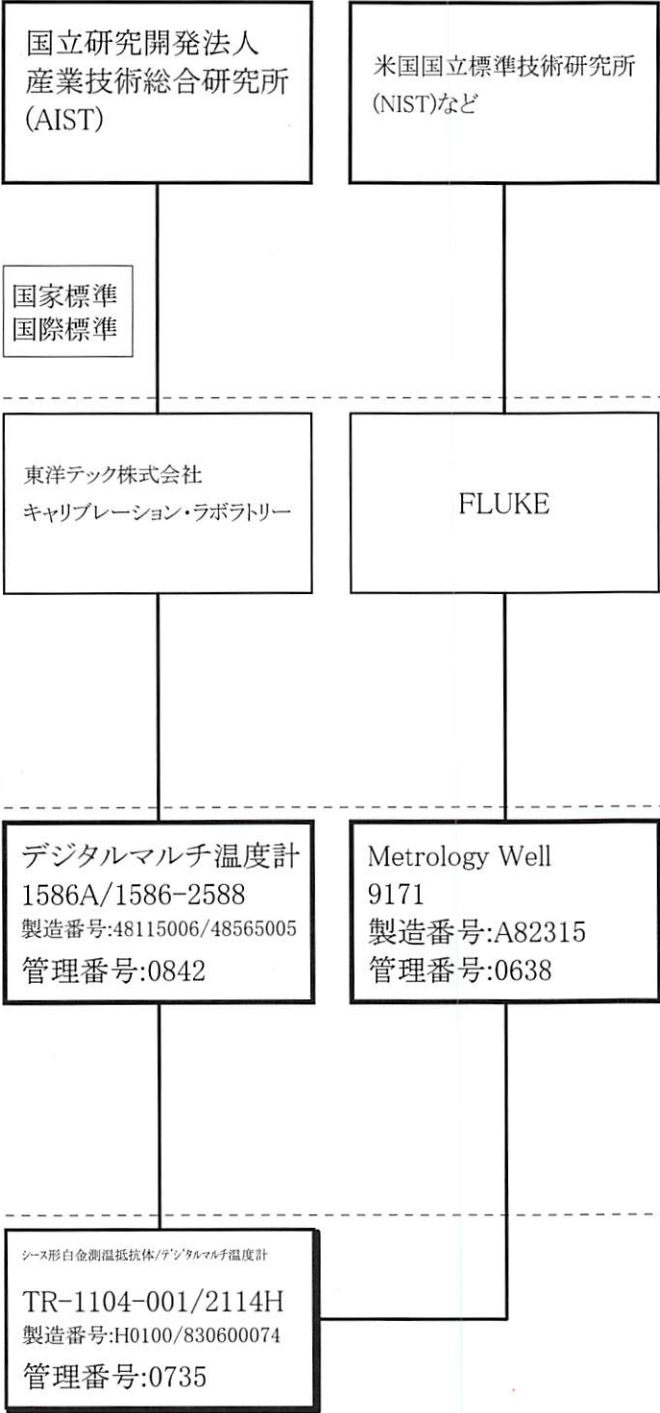

使用標準器

校正証明書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿
型式 RTR501B
名称 Wireless Thermo Recorder
製造者 ティアンドデイ
製造番号 52801DA2
管理番号 H-2


東洋テック株式会社
〒101-0021
東京都千代田区外神田1-3-12
TEL 03-3251-8676
FAX 03-3251-8258

試験年月日 2024年 2月 5日
試験環境 温度 : 23℃ 湿度 : 50%
試験場所 浜松キャリブレーションセンター
静岡県浜松市中央区上西町60-3

承認者 佐藤 修平



受領時の機器状態: 校正作業に影響がある外観・機能の異常は見受けられませんでした。
出荷時の機器状態: 測定した項目は仕様を満たしており、調整の実績はありません。

上記の計測器は、当社の品質システムにしたがって校正が行なわれたことを証明します。
この校正に使用した下記の標準器は、日本電気計器検定所及び日本品質保証機構などの
公的校正機関、または米国国立標準技術研究所(NIST)などの国際度量衡委員会に加盟し
ている諸外国の公的校正機関にトレーサビリティがとれています。

使用標準器

管理番号	型式	名称	成績書番号	製造番号	有効期限
0735	TR-1104-001/2114H	シース形白金測温抵抗体/デジタルマルチ温度計	0735-23	H0100/830600074	2024年 8月

注) ・使用標準器の有効期限は表示月の末日です。

試験成績書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

東洋テック株式会社

型 式 RTR501B
名 称 Wireless Thermo Recorder
製 造 者 ティアンドデイ
製造番号 52801DA2
管理番号 H-2

承認者 佐藤 修平
試験者 佐藤 修平

試験年月日 2024年 2月 5日
試験環境 温度 : 23℃ 湿度 : 50%
試験場所 浜松キャリブレーションセンター
静岡県浜松市中央区上西町60-3

総合判定 良

使用標準器

管理番号	型式	名称	成績書番号	製造番号	有効期限
0735	TR-1104-001/2114H	シース形白金測温抵抗体/デジタルマルチ温度計	0735-23	H0100/830600074	2024年 8月

試験成績

温度指示確度

レンジ	校正値	許容下限値	表示値	許容上限値	判定
-40 ℃	-30.0 ℃	-30.50	-29.7 ℃	-29.50	良
80 ℃	0.0 ℃	-0.50	0.0 ℃	0.50	良
80 ℃	30.0 ℃	29.50	29.7 ℃	30.50	良

備考:

以下余白

校正仕様書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

型 式 RTR501B
名 称 Wireless Thermo Recorder
製 造 者 ティアンドデイ
製造番号 _____
管理番号 _____

試験年月日 ____年__月__日
試験環境 温度 : ____℃ 湿度 : ____%
試験場所 _____



承 認
2024/1/30

試験成績

温度指示確度

レンジ	校正値	表示値		判定基準
-40 ℃	-30.0 ℃	_____℃	±	0.5 ℃
80 ℃	0.0 ℃	_____℃	±	0.5 ℃
80 ℃	30.0 ℃	_____℃	±	0.5 ℃

以下余白


トレーサビリティチャート

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

東洋テック株式会社



型式 RTR501B
名称 Wireless Thermo Recorder
製造番号 52801DA2
管理番号 H-2
試験年月日 2024年 2月 5日

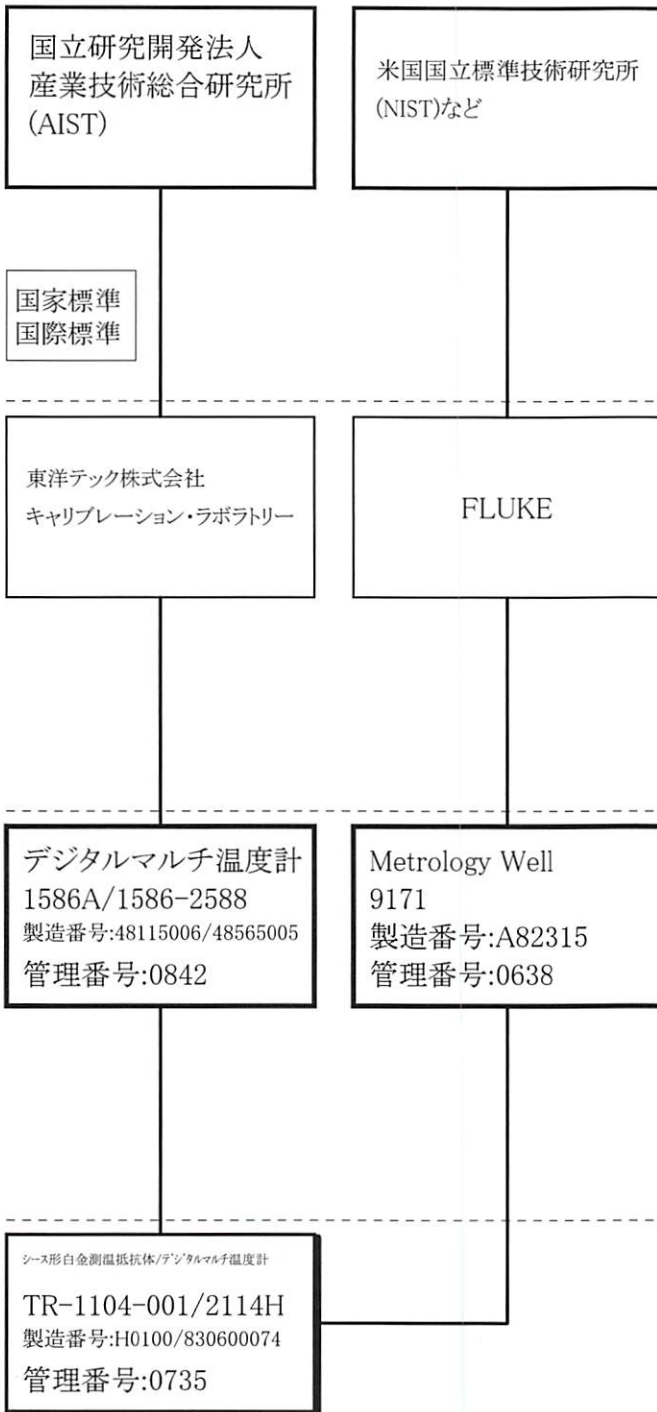国家標準
国際標準東洋テック株式会社
キャリブレーション・ラボラトリー

FLUKE

デジタルマルチ温度計
1586A/1586-2588
製造番号:48115006/48565005
管理番号:0842Metrology Well
9171
製造番号:A82315
管理番号:0638シース形白金測温抵抗体/デジタルマルチ温度計
TR-1104-001/2114H
製造番号:H0100/830600074
管理番号:0735

使用標準器

校正証明書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

型式 RTR501B
名称 Wireless Thermo Recorder
製造者 ティアンドデイ
製造番号 52801B1A
管理番号 W-2


東洋テック株式会社
〒101-0021
東京都千代田区外神田1-3-12
TEL 03-3251-8676
FAX 03-3251-8258

試験年月日 2024年 2月 5日
試験環境 温度 : 23℃ 湿度 : 50%
試験場所 浜松キャリブレーションセンター
静岡県浜松市中央区上西町60-3

承認者 佐藤 修平



受領時の機器状態: 校正作業に影響がある外観・機能の異常は見受けられませんでした。
出荷時の機器状態: 測定した項目は仕様を満たしており、調整の実績はありません。

上記の計測器は、当社の品質システムにしたがって校正が行なわれたことを証明します。
この校正に使用した下記の標準器は、日本電気計器検定所及び日本品質保証機構などの
公的校正機関、または米国国立標準技術研究所(NIST)などの国際度量衡委員会に加盟し
ている諸外国の公的校正機関にトレーサビリティがとれています。

使用標準器

管理番号	型式	名称	成績書番号	製造番号	有効期限
0735	TR-1104-001/2114H	シース形白金測温抵抗体/デジタルマルチ温度計	0735-23	H0100/830600074	2024年 8月

注) ・使用標準器の有効期限は表示月の末日です。

試験成績書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

型式 RTR501B
名称 Wireless Thermo Recorder
製造者 ティアンドデイ
製造番号 52801B1A
管理番号 W-2

東洋テック株式会社

承認者 佐藤 修平

試験者 佐藤 修平

試験年月日 2024年 2月 5日
試験環境 温度 : 23℃ 湿度 : 50%
試験場所 浜松キャリブレーションセンター
静岡県浜松市中央区上西町60-3

総合判定 良

使用標準器

管理番号	型式	名称	成績書番号	製造番号	有効期限
0735	TR-1104-001/2114H	シース形白金測温抵抗体/デジタルマルチ温度計	0735-23	H0100/830600074	2024年 8月

試験成績

温度指示確度

レンジ	校正値	許容下限値	表示値	許容上限値	判定
-40 ℃	-30.0 ℃	-30.50	-29.7 ℃	-29.50	良
80 ℃	0.0 ℃	-0.50	0.1 ℃	0.50	良
80 ℃	30.0 ℃	29.50	29.8 ℃	30.50	良

備考:

以下余白

校正仕様書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

型 式 RTR501B
名 称 Wireless Thermo Recorder
製 造 者 ティアンドデイ
製造番号 _____
管理番号 _____

試験年月日 ____年__月__日
試験環境 温度 : ____℃ 湿度 : ____%
試験場所 _____



承認
2024/1/30

試験成績

温度指示確度

レンジ	校正値	表示値		判定基準
-40 ℃	-30.0 ℃	_____℃	±	0.5 ℃
80 ℃	0.0 ℃	_____℃	±	0.5 ℃
80 ℃	30.0 ℃	_____℃	±	0.5 ℃

以下余白


トレーサビリティチャート

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

東洋テック株式会社



型 式 RTR501B
名 称 Wireless Thermo Recorder
製造番号 52801B1A
管理番号 W-2
試験年月日 2024年 2月 5日

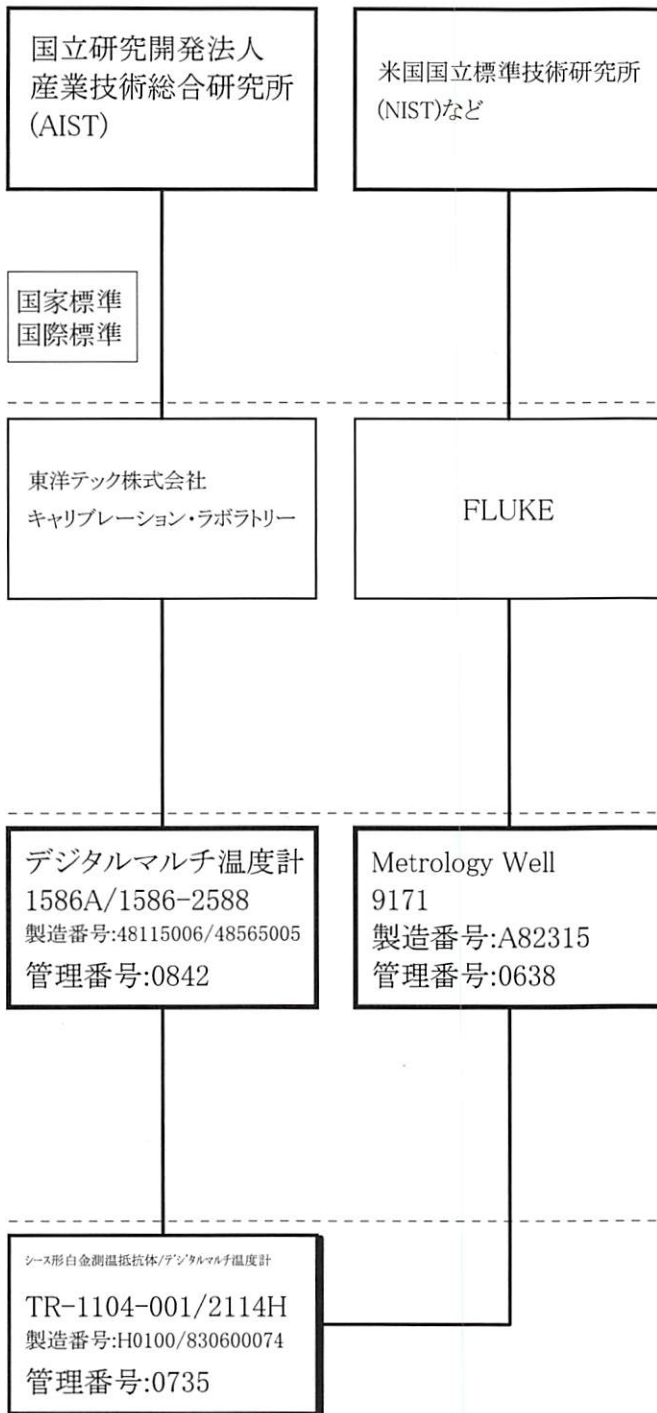

使用標準器

校正証明書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

型 式 RTR501B
名 称 Wireless Thermo Recorder
製 造 者 ティアンドデイ
製造番号 5280196F
管理番号 Z-2

東洋テック株式会社
〒101-0021
東京都千代田区外神田1-3-12
TEL 03-3251-8676
FAX 03-3251-8258

試験年月日 2024年 2月 5日
試験環境 温度 : 23℃ 湿度 : 50%
試験場所 浜松キャリブレーションセンター
静岡県浜松市中央区上西町60-3

承認者 佐藤 修平

受領時の機器状態: 校正作業に影響がある外観・機能の異常は見受けられませんでした。
出荷時の機器状態: 測定した項目は仕様を満たしており、調整の実績はありません。

上記の計測器は、当社の品質システムにしたがって校正が行なわれたことを証明します。
この校正に使用した下記の標準器は、日本電気計器検定所及び日本品質保証機構などの
公的校正機関、または米国国立標準技術研究所(NIST)などの国際度量衡委員会に加盟し
ている諸外国の公的校正機関にトレーサビリティがとれています。

使用標準器

管理番号	型式	名称	成績書番号	製造番号	有効期限
0735	TR-1104-001/2114H	シース形白金測温抵抗体/デジタルマルチ温度計	0735-23	H0100/830600074	2024年 8月

注) ・使用標準器の有効期限は表示月の末日です。

試験成績書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

東洋テック株式会社

型式 RTR501B
名称 Wireless Thermo Recorder
製造者 ティアンドデイ
製造番号 5280196F
管理番号 Z-2

承認者 佐藤 修平
試験者 佐藤 修平

試験年月日 2024年 2月 5日
試験環境 温度 : 23℃ 湿度 : 50%
試験場所 浜松キャリブレーションセンター
静岡県浜松市中央区上西町60-3

総合判定 良

使用標準器

管理番号	型式	名称	成績書番号	製造番号	有効期限
0735	TR-1104-001/2114H	シース形白金測温抵抗体/デジタルマルチ温度計	0735-23	H0100/830600074	2024年 8月

試験成績

温度指示確度

レンジ	校正値	許容下限値	表示値	許容上限値	判定
-40 ℃	-30.0 ℃	-30.50	-29.7 ℃	-29.50	良
80 ℃	0.0 ℃	-0.50	0.0 ℃	0.50	良
80 ℃	30.0 ℃	29.50	29.7 ℃	30.50	良

備考:

以下余白

校正仕様書

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿

型 式 RTR501B
名 称 Wireless Thermo Recorder
製 造 者 ティアンドデイ
製造番号 _____
管理番号 _____

試験年月日 ____年__月__日
試験環境 温度 : ____℃ 湿度 : ____%
試験場所 _____



承 認
2024/1/30

試験成績

温度指示確度

レンジ	校正値	表示値		判定基準
-40 ℃	-30.0 ℃	_____℃	±	0.5 ℃
80 ℃	0.0 ℃	_____℃	±	0.5 ℃
80 ℃	30.0 ℃	_____℃	±	0.5 ℃


以下余白

トレーサビリティチャート

依頼者名 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 殿



型 式 RTR501B
名 称 Wireless Thermo Recorder
製造番号 5280196F
管理番号 Z-2
試験年月日 2024年 2月 5日

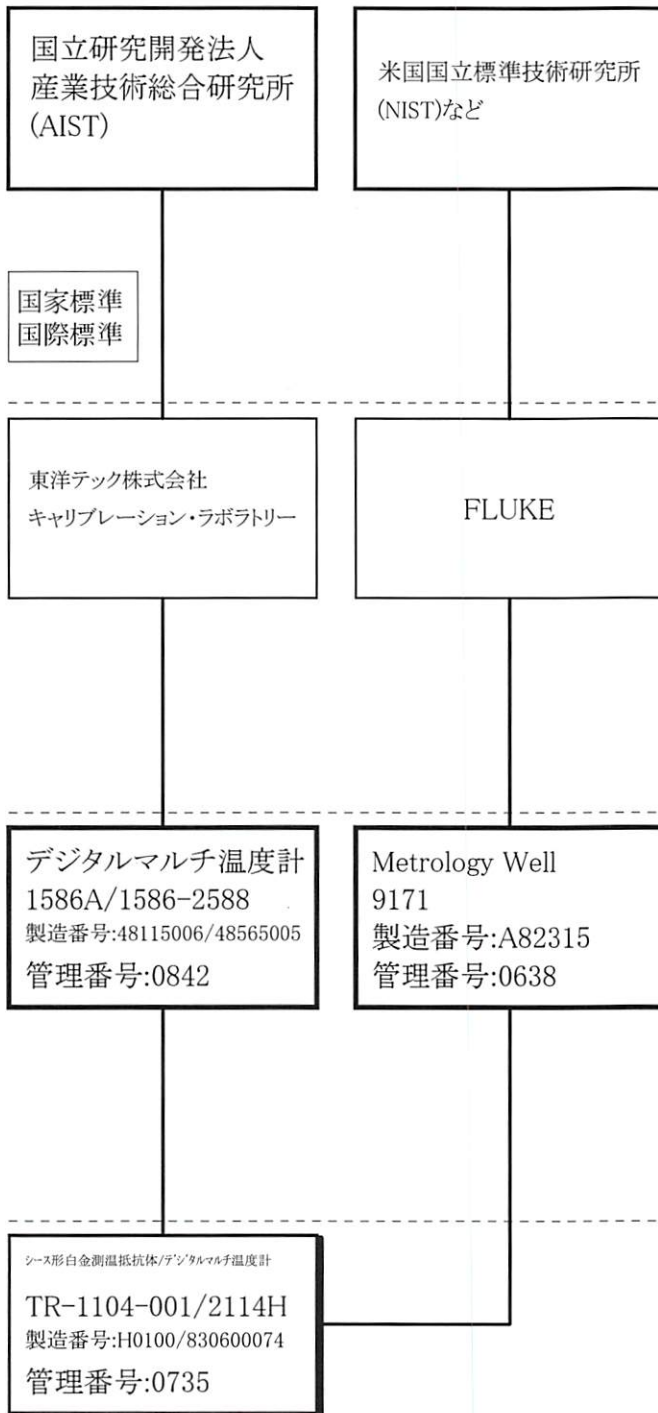

使用標準器